

ASS-OS POWER DYNAMIC - Aparat Na Opadającą Stopę

**Cena :****1.157,00 zł**Nr katalogowy : **ASS-OS**Producent : **ART-REH**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena :

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Aparat na opadającą stopę typu otwartego, wykonany z włókna węglowego. Posiada dwa pasy mocujące. Od przodu, na goleni wyłożony jest miękką tkaniną dobrze wchłaniającą pot, antyalergiczny, idealnie dopasowany do kształtu golenia. Dzięki swojej sztywności i budowie doskonale stabilizuje stopę przed opadaniem a boczna szyna zabezpiecza staw skokowy przed zwichnięciem zarówno od wewnątrz jak i na zewnątrz.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, aparat ten jest bardzo lekki, sztywny a zarazem plastyczny.

WŁAŚCIWOŚCI

1. **Doskonała stabilizacja** - doskonale zabezpiecza stopę przed opadaniem jak również przed skręceniem bocznym.
2. **Komfort użytkowania** - doskonale dopasowany do kończyny pacjenta poprzez zastosowanie taśm mocujących i przedniej wyściółki.
3. **Łatwość użytkowania** - możliwość wsadzenia do buta i ukrycia pod spodniami.
4. **Niska waga wyrobu** - lekki, stabilny, plastyczny.
5. **Utrzymanie właściwej higieny** - ze względu na łatwość zakładania i zdejmowania aparatu, pacjent ma możliwość łatwego wyprania jego elementów, jak również utrzymania właściwej higieny kończyny dolnej.

PRZEZNACZENIE:

Aparat można stosować w przypadkach:

- porażenia stóp,
- niedowładu stóp,
- stany po skręceniach stóp w celu doleczenia,
- stany po zabiegach operacyjnych w fazie rekonwalescencji

PRZECIWSKAZANIA:

Ortezy nie należy stosować w przypadku:

- świeżych ran
- otarć naskórka
- egzem skórnych
- alergii skórnych

ZASTOSOWANIE:

Rehabilitacja, ortopedia, neurologia i neurochirurgia.


SPOSÓB ZAKŁADANIA APARATU:



INFORMACJE DLA PACJENTA:

1. Stosować ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza.
2. Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny.
3. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja i pranie wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, albo powstanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

GRAFICZNY SCHEMAT ZAKŁADANIA APARATU:

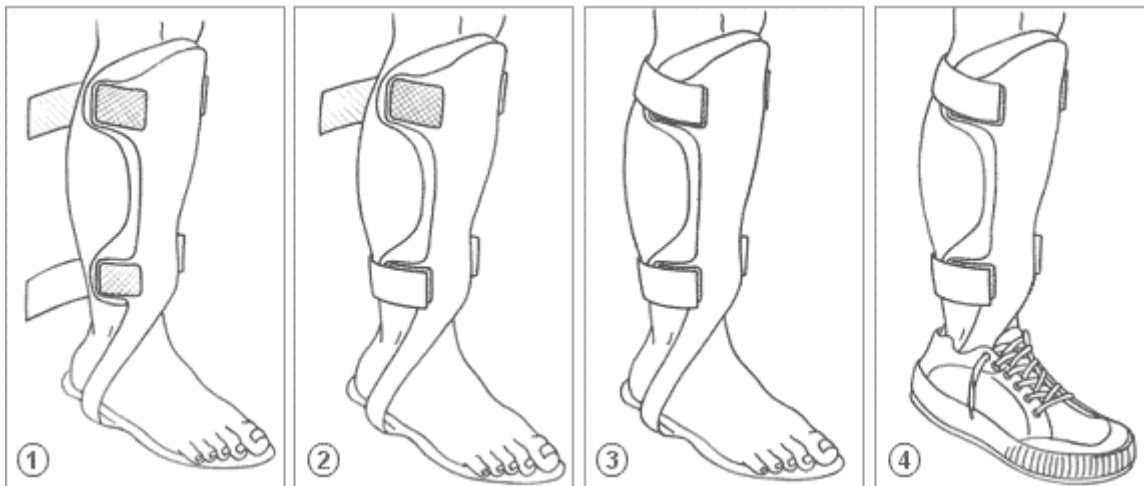

KONSERWACJA:


1. Wyściółkę przednią golenia prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem mydła w temperaturze do 30 stopni.
2. Nie prasować.
3. Nie chlorować.
4. Suszyć z daleka od źródeł ciepła

SKŁAD SUROWCOWY:

Włókna węglowe, pianka poliuretanowa, dzianina welurowa, dzianina frotte, pasy VELCRO

KODY REFUNDACYJNE NFZ

Kod środka	Przeznaczenie	Opłatność	Okres używalności	Lekarze Upoważnieni	Limit NFZ
9130.15 Aparat DAFO	Do chodzenia w dysfunkcji stóp, uszkodzenie neuronu centralnego lub obwodowego	bezpłatnie do wysokości limitu	raz na trzy lata dysfunkcja stała	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	250 zł
9130.05 Aparat na opadającą stopę	Stopa opadająca, przeciwdziałaniu opadaniu stopy - do dowolnego obuwia	bezpłatnie do wysokości limitu	raz na trzy lata dysfunkcja stała	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	140 zł

**Sposób pomiaru:**

Długość stopy

Dostępne**rozmiary:****M** - 24-27 cm**L** - 25-29 cm**PRAWA/LEWA**

[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk](#)
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)



[Chcesz za darmo połączyć się telefonicznie z naszym konsultantem](#)
[naciśnij zieloną słuchawkę](#)

Tagi:

[ASS-OS POWER DYNAMIC - Aparat Na Opadającą Stopę, Ortezy, Orteza, Stabilizatory Stawu, Stabilizator Stawu, Sklep Medyczny, Sklepy Medyczne, Orteza Stawu Skokowego, Art-Reh](#)
